

**Informations règlementaires**

Marquage	Indice de classement	Organisme notifié	<b><del>PHTALATES LATEX</del></b>
CE 0459	Im	G-MED	

- Manomètre de précision gradué de 0 à 120 cm H2O
- Mécanisme en laiton qualité horlogère
- Poire de gonflage en PVC sans latex
- Raccordement assuré par raccord cône standard Luer
- Cadran sectorisé par zone colorée pour une meilleure perception des pressions

**1 - Identification du dispositif**

Visuel de face



**2 - Références**

Référence	Désignation	Dimensions en mm	
		Longueur	Largeur
IP01	Inflateur de pression	180	70

Largeur

Longueur



**3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi**

Avant toute utilisation, il est impératif de contrôler l'étanchéité générale du dispositif médical. Pour ce faire, procéder de la manière suivante :

- 1) Obturer la sortie d'air en pressant un doigt sur celle-ci.
- 2) Presser la poire de gonflage pour afficher une pression de 120 cm H2O.
- 3) Contrôler la stabilité de l'aiguille pendant 3-4 secondes.

Si le test est positif l'inflateur est prêt à être utilisé.


Au cas où la pression n'est pas stabilisée, faire vérifier votre manomètre par le fabricant.

Mode d'emploi :

- Raccorder l'embout cône Luer au tube de liaison du ballonnet de la sonde endotrachéale.
- Gonfler le ballonnet à une pression d'environ 60 à 90 cm H<sub>2</sub>O, cela permet au ballonnet de se plaquer contre les parois de la trachée.
- Dévisser ensuite légèrement la molette à gauche du manomètre afin de réduire et afficher une pression comprise entre 22 et 32 cm H<sub>2</sub>O, correspondant à la zone verte matérialisée sur le cadran de l'inflateur.
- Bloquer la molette.
- A tout moment il est possible de contrôler la pression du ballonnet et d'en modifier la valeur en agissant sur la poire ou la molette de décompression.

**4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles**

Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
A	IP01	Inflateur de pression	Dispositif complet
B	A10362	Verre	Polycarbonate
C	A10363	Protecteur supérieur de manomètre	Polyuréthane
D	A10364	Boîtier manomètre	Aluminium
E	A10365	Corps	Aluminium
F	A10226	Poire de gonflage	PVC sans phtalates
G	A10366	Protecteur inférieur de manomètre	Polyuréthane
H	A10373	Mécanisme 0-120 mmHg	Laiton
I	A10368	Valve + filtre + rondelle + circlips	
J	A10372	Protecteur intermédiaire	EPDM
	TIP01	Tube de liaison	PVC sans phtalates

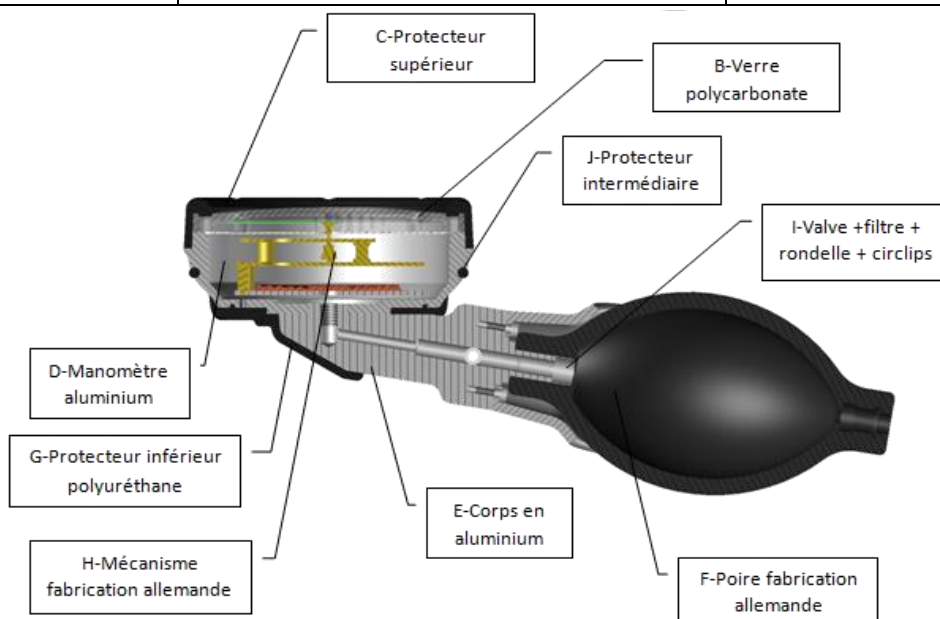

## 5 - Nettoyage désinfection

Pulvérisation de solutions décontaminantes . Ne pas utiliser de détergeant, ne pas immerger.

## 6 - Maintenance

Contrôle visuel / Etanchéité	Contrôle étalonnage
Avant chaque utilisation	tous les 12 mois

L'inflateur de ballonnet est un dispositif médical de mesure et doit faire l'objet de précaution pour éviter toute chute. Il est nécessaire de faire contrôler son étalonnage régulièrement ainsi que ses principales fonctionnalités (étanchéité, décompression). Nous recommandons un contrôle tous les 12 mois.

## 7 - Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT
IP01	1

## 8 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40 ° c	30 à 40 %	500 à 1060 hpA

## 9 – Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

La durée de cette garantie est de 24 mois.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.